今 企業コンプライアンスが問われています!

i-Checker Ⅱ FT-001A

定価 32,200円(税別)



導入コストは業務用記録型で最安、アフターサービスも万全

メンテナンスは12,200円（税別）にて製品交換
新品同等品と製品交換を行い、再度1年間の動作保証付き。

SDカードに日時とデータを記録・付属のソフトでPC一括管理！

SDカードの記録データをPCに一括取込。
運転者毎・日時毎と必要なデータ毎に閲覧や印刷が可能。
管理者方の強い味方です。CSVファイル出力機能も標準装備。



小型でありながら据置型を超えた高性能・高効率

場所を取るシステム構築も不要で、事務所に複数台置けば出庫・
帰庫時の測定漏れも解消

クローズドブロー方式で呼気検知圧力センサーを搭載

呼気量不足、呼気以外の風圧、吸い込み等による不正測定を抑止。

(財)化学物質評価研究機構　CERI にて、
国内唯一「精度評価試験」を受け情報を公開。
信頼性及び精度の高さが証明されております。

詳しくはホームページで　メルモ アルコール　検索　https://www.melmo.co.jp/

社内安全風土強化に向けた、その他の特徴

● ブザー音

測定中とアルコールを検知した場合とをそれぞれ音の違いで
確認が出来ます。

● 電話でも確認可能なブザー音

従来製品のブザー音は電話を通じると聞こえませんでした。
FT-001Aなら電話の受話器を通じても相手先のブザー音が
明瞭に聞こえますので、電話点呼時や外出先できちんと
測定しているかどうかとアルコールを検知した場合も
その場で確認が可能。

● 使用回数期限を音と画面表示でお知らせ

本製品の使用期限（精度保証）は、ご購入後１年間又は
3,000回使用のどちらか早い方ですが、常時有効保持義務違反
にならないように、使用回数期限が近づきますとブザーと
画面表示でお知らせします。

◆平成 23年 5月 1日 施行！◆

自動車運送事業者には、アルコール検知器の使用が義務化されました。

◆改正の概要◆

- 事業者は、点呼時に酒気帯びの有無を確認する場合には、目視等で確認するほか、アルコール検知器を用いて行い、**その内容を記録しなければならない。**
- 事業者は、営業所ごとにアルコール検知器を備え、**常時有効に保持しなければならない。**
- 事業者は、アルコール検知器の**故障の有無を定期的に確認しなければならない。**
- 電話点呼の場合には、**運転者にアルコール検知器を携行させ、検知結果を報告させるとともにその内容を記録しなければならない。**

◆行政処分基準◆

●アルコール検知器の備え義務違反
※備えなし初違反60日車
※備えなし再違反180日車
●アルコール検知器の常時有効保持義務違反
※初違反20日車
※再違反60日車


【常時有効保持】とは
正常に作動し、故障がない状態で保持することをいう。
取扱説明書に基づき、使用し保持するとともに、定期的
に故障の有無を確認し故障していないものを使用すること。

測定のしかた

準　備

1 マウスピースを取り出す


本体のマウスピース収納部からマウスピースを取り出します。




2 マウスピースを差し込む

本体のマウスピース差し込み口にマウスピースを差し込みます。



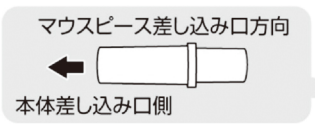

測定開始




3 ENTER キーを押す

「ピッ」と音が鳴りウオーミングアップが始まり、表示画面に「0」→「00」→「000」と表示されます。


※ 同時にユーザー ID と測定回数が表示されますので、必ず自分のユーザー ID が表示されたことを確認してください。

POINT この間しかユーザー ID は表示されませんのでご注意ください。



「ピッ」と音が鳴りカウントダウンを始まります。

※ 通常は「5」から始まりますが、長い間使用していない場合、または前回の測定結果が高い値を示した場合には「20」から始まります。



「ピピッ」と音が鳴り表示画面に「BLOW」が表示され、測定可能状態になります。(5 秒間)



ここまでの途中で測定を中止したい場合、再度 ENTER キーを押すと測定を中止することができます。(測定回数にはカウントされません)

4 マウスピースに息を吹き込む

測定可能状態の 5 秒以内にマウスピースをくわえ、息を吹き込みます。




「ピー」音が鳴っている間、一定の強さで息を吹き込みつづけてください。

MEMO 測定時の正しい持ちかた

測定時に本体を正しく持たないと正確な測定ができません。



グリップ部から指がはみ出さないように握ります。



測定時にガス抜け口をふさいでいると正確な測定ができません。

5 息を吹き込むのをやめる

「ピピッ」と鳴って音が止まりますので、息を吹き込むのをやめます。



表示画面に測定結果が表示されます。microSD カード書き込みマークが点灯し、約 10 秒経過後に画面の表示が消えますが、この間は絶対に microSD カードを抜かないでください。

以上で測定が終了です。

ご購入アドバイス

- ある程度使用台数に余裕をお持ちいただくか（非常時の予備）もしくは、日々の業務に支障のない範囲で定期交換に出されることをお勧めします。
- マイクロＳＤカードはドライバーの人数分をご用意下さい。
- マウスピースは3個付属していますが、ある程度余分をご用意下さい。(10個入800円税別)

総販売代理店
株式会社　メルモ　　URL ：**https://www.melmo.co.jp**
本社：〒666-0011 兵庫県川西市出在家町3-14
電話：072-744-6700　　FAX：072-744-6702
お客様コールセンター：〒530-0001　大阪府大阪市北区梅田1-11-4-1100
電話：06-4799-9690　FAX：06-4799-9691
製造元
テックウェルインターナショナルジャパン株式会社

ご使用前の準備

■microSD カードのセットのしかた

実施 **必ずユーザー ID を登録した microSD カードをセットしてください。**

※ 未登録の microSD カードを使用した場合、本体表示画面に「Er 1」と表示され、測定することができません。

POINT microSD カードを本体にセットせずに測定した場合、測定はできますが測定データは保存できませんので十分ご注意ください。(ユーザー ID と SD マークも本体に表示されません。)

1 microSD カード挿入口カバーを開ける

microSD カード挿入口カバーにツメを引っ掛けて、図の矢印の向きに開けます。



2 microSD カードを差し込む

MicroSD カードを挿入口の奥に「カチッ」と音がするまでしっかり差し込みます。



3 microSD カード挿入口カバーを閉める

microSD カード挿入口カバーを元通りに閉めます。



商　品　構　成

(その他付属品：取扱い説明書・保証書)



項目	内容
検知方式	半導体ガスセンサー
対象ガス	呼気中アルコール
測定範囲	0.00、0.05 ～ 0.25 mg /L
サンプリング方式	チェッカー吹き込み口への呼気吹き込み方式
起動・終了	ENTER キーにより自動スタートおよびオートパワーオフ
測定待ち時間	電源投入後５秒または 20 秒の自動切替
吹き込み時間	約５秒
LCD 表示	日付・時間・測定待ち時間・測定結果・電池残量など
外部出力	microSD カード（FAT16 形式）
電源	単４形アルカリ乾電池× 2
電池寿命	約 700 回程度
使用温度範囲	0～40℃ (湿度 80%以下、結露なきこと)
保管温度範囲	－ 20 ～ 60℃ (湿度 80%以下、結露なきこと)
外形寸法	120(H) × 60(W) × 25(D) mm
質量	約 110g（単４形アルカリ乾電池２本含む）

アフターサービス

●保証期間は、お買上げ日から1年間、または測定回数3000回です。（いずれか早い方です）

本製品は、定期的に機器の製品交換を行い測定精度を一定に保つ必要があります。（定期点検費用　12,200 円税別）

次の条件を満たした場合、ご依頼下さい。

1. 購入してから、1 年が経過した。
2. 測定回数が3000回を超えた。
※どちらか早い方

修理または、校正機器との定期交換のご依頼は販売店もしくはこちらのURLまで　**https://m.o-l-o.jp**

販売店